


Оригінальна інструкція з експлуатації

Професійна морозильна камера

Перед введенням в експлуатацію прочитайте інструкцію з експлуатації

сторінка 82

UK

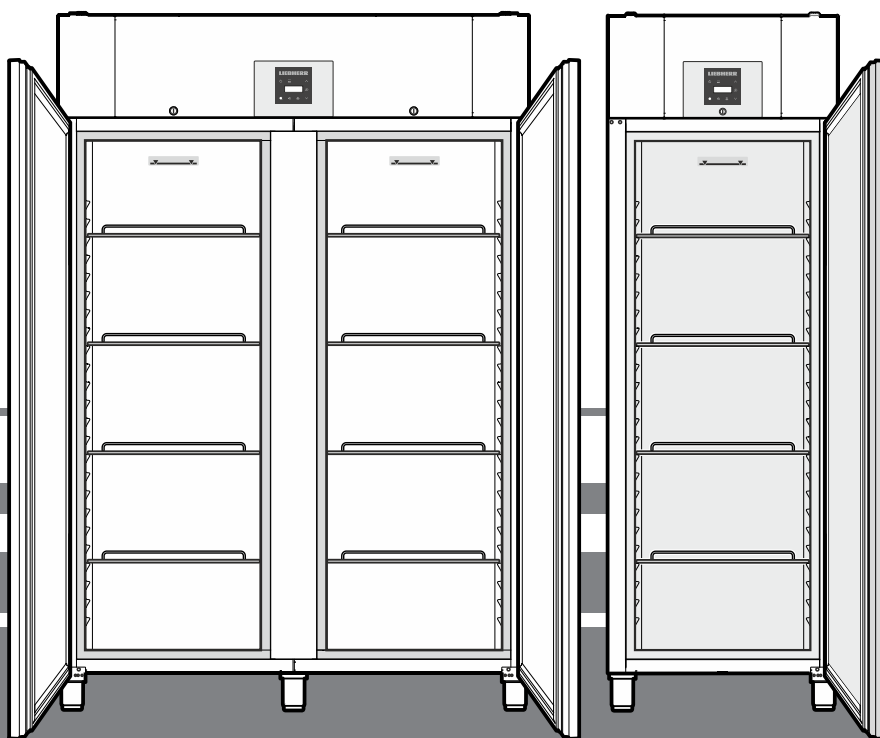

GGPv 6520

GGPv 6570

GGPv 1470

7085 929-01

LIEBHERR

Зміст


Градація попереджень.....	82
Вказівки з техніки безпеки та попередження.....	82
Символи на приладі	83
Використання за призначенням	83
Передбачуване неправильне застосування.....	83
Декларація про відповідність.....	83
Акустична емісія приладу.....	83
Кліматичний клас.....	83
Опис приладу.....	84
Установка.....	84
Вирівнювання приладу	84
Електричне під'єднання.....	84
Розміри приладу.....	85
Обладнання	85
Замок з секретом	85
Елементи для обслуговування і контролю	86
Увімкнення і вимкнення приладу.....	86
Регулювання температури	86
Режим індикації температури	86
SuperFrost (супер-мороз).....	86
Сигналізація відкритих дверей.....	86
Налаштування часу затримки для сигналізації відкритих дверей.....	87
Деактивація функції звукового попереджувального сигналу	87
Перевірка сигналізації.....	87
Аварійні повідомлення.....	87
Налаштування параметрів сигналізації.....	87
Зчитування температурного режиму	88
Скидання аварійних станів	88
Скидання записаного температурного режиму rt	88
Скидання параметрів до заводських налаштувань	88
Зберігання.....	88
Розморожування.....	88
Ручне увімкнення функції розморожування.....	88
Налаштування індикації на дисплеї під час фази розморожування.....	88
Очищення.....	89
Вказівки з утилізації	89
Несправності	89
Можливі повідомлення про помилку на дисплеї.....	89
Виведення приладу з експлуатації.....	89
Перенавішування дверей GGPv 65.....	90

Градація попереджень

⚠ НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередню небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті або важких тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
⚠ ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до легких або середніх тілесних ушкоджень, якщо її не попередити.
Увага	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до матеріальної шкоди, якщо її не попередити.
Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

Вказівки з техніки безпеки та попередження

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не закривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або в корпусі для монтажу. →



- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для прискорення розморожування використовуйте лише механічні пристрої чи інші засоби, які були рекомендовані виробником.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не пошкоджуйте контур холодоагенту.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте у відділі охолодження електричні прилади, які не відповідають рекомендованому виробником типу.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте обережні, щоб не пошкодити шнур живлення під час установки приладу.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не можна розміщувати і експлуатувати мережеві розгалужувачі та інші електроприлади (напр., трансформатори для галогенних ламп) у задній частині приладів.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** цей прилад повинен бути закріплений згідно з інструкцією з експлуатації (інструкцією з монтажу), щоб запобігти небезпекам, що виникають через недостатню стійкість.


- Діти від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями або без достатнього досвіду і знань можуть користуватися приладом тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання приладу і розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з приладом. Дітям забороняється виконувати очищення й технічне обслуговування, якщо вони перебувають без нагляду. Дітям від 3 до 8 років не дозволяється завантажувати і розвантажувати холодильники/морозильну камеру.

- Не зберігайте у приладі вибухонебезпечні матеріали, напр., аерозольні упаковки з горючими газами.


- Щоб запобігти небезпеці травмування і пошкодження матеріальних цінностей, прилад повинні встановлювати 2 людини.

Опис приладу

GGPv 1470

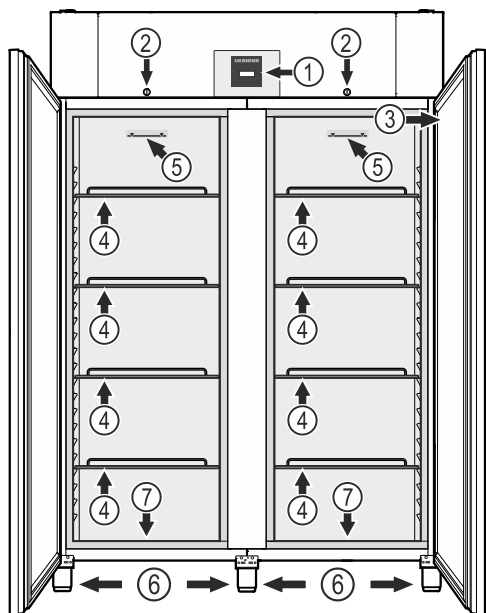

GGPv 6520, GGPv 6570

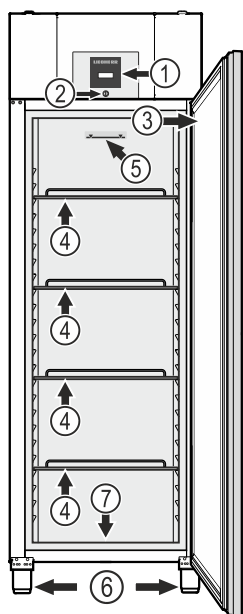

- (1) Елементи для обслуговування і контролю
- (2) Замок
- (3) Заводська табличка
- (4) Ґратчасті полиці
- (5) Позначка укладання
- (6) Ніжки
- (7) Отвір стоку води для миття

УВАГА


Максимальне завантаження кожної полиці складає 60 кг.

Отвір стоку води для миття

На нижньому боці приладу можна під'єднати шланг для стоку зі з'єднанням R 3/4.

Це дозволяє відводити воду, що збирається під час очищення внутрішнього простору.

Кутовий з'єднувач додається до приладу.

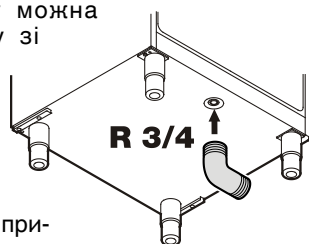


Установка

- Не встановлюйте на прилад інші тепловиділяючі прилади, напр., мікрохвильові печі, тостери та ін.
- Не встановлюйте на прилад інші тепловиділяючі прилади, напр., мікрохвильові печі, тостери та ін.
- Чим більше холодоагенту міститься в пристрої, тим ільшим має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодоагенту вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- Відстань між верхнім краєм приладу і стелею приміщення повинна складати не менше ніж 30 см.

Вирівнювання приладу

Компенсуйте нерівності підлоги за допомогою регульованих ніжок.


Для регулювання висоти повертайте нижню частину відповідної ніжки.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Висота ніжки регулюється у діапазоні від 120 мм до 170 мм.

Не налаштовуйте ніжку на висоту більше 170 мм! Нижня частина ніжки може через це від'єднатися, через що прилад перекинеться.



Це може призвести до важких або смертельних травм.

УВАГА

Прилад повинен бути вирівняний горизонтально й вертикально. Коли прилад стоїть навскіс, корпус приладу може деформуватися і двері не закриватимуться правильно.

Електричне під'єднання

Підключайте прилад лише до мережі **перемінного струму**.


Допустимі значення напруги та частоти зазначені на заводській табличці. Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

Розетка повинна бути заземлена належним чином та оснащена електричним запобіжником.

Значення струму спрацювання запобіжника повинно знаходитися в діапазоні від 10 А до 16 А.


Розетка не повинна знаходитися за приладом, вона повинна бути легкодоступною.

Не підключайте прилад через подовжувач або трійник.



Не застосовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний або енергозберігаючий штекер. Можливе пошкодження електричних компонентів!

Розміри приладу

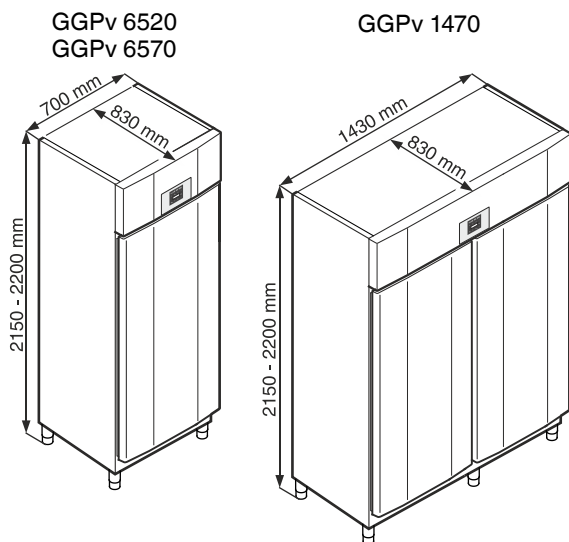

Обладнання



Устромляння ґратчастих полиць


Замок з секретом

Замок у дверях приладу обладнаний секретом.

Замикання приладу


- Притисніть ключ в напрямку 1.
- Поверніть ключ на 180° (2).

Щоб знову відперти прилад, дійте у такій самій послідовності.

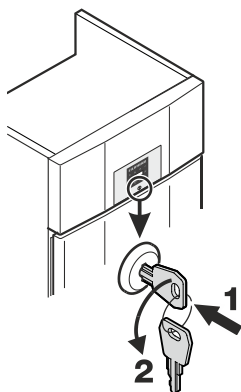


Обладнання GGPv 1470


Надіньте додані опорні рейки праворуч і ліворуч на вертикальну перемичку.

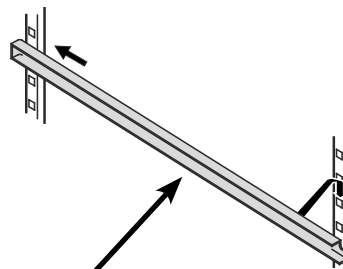

Спочатку встроміть рейки на бажаній висоті у задній рейці з отворами, а потім навесьте їх спереду.

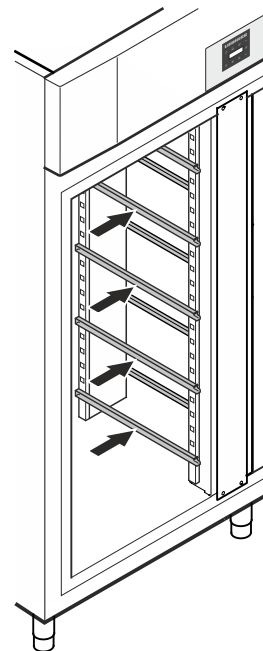

Проміжні полиці

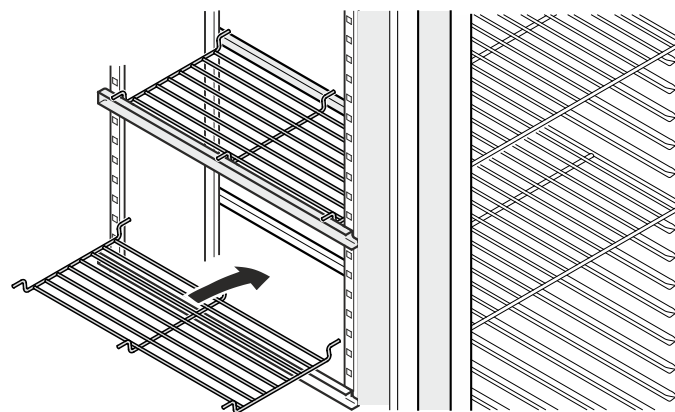

Установіть додані проміжні полиці на опорні рейки.

УВАГА

Максимальне завантаження кожної проміжної полиці складає 20 кг.

Елементи для обслуговування і контролю



Кнопка ON/OFF (увімкнення і вимкнення приладу)

Кнопка опитування збережених аварійних станів

Кнопки вибору

Кнопка режиму Superfrost

Кнопка вимкнення аварійної сигналізації

Кнопка розморожування (Ручне увімкнення функції розморожування)

Кнопка Enter (налаштування)

Символи на дисплеї

Компресор працює

Світлодіод блимає – витримка часу при увімкненні холодильного агрегату. Після вирівнювання друку у контурі охолодження компресор вмикається автоматично.

Вентилятор працює

Прилад знаходиться у режимі розморожування

Індикація означає реєстрацію параметрів електроживлення і температури всередині приладу.

Блимання на дисплеї означає, що або мало місце відключення електроживлення або температура всередині приладу знаходилася у неприпустимому діапазоні.

Режим SuperFrost увімкнений

Функція аварійної сигналізації

Це свідчить про несправність приладу. Зверніться у службу сервісу.

Увімкнення і вимкнення приладу

Встроміть штепсель. Індикатор = OFF.

Увімкнення приладу

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор = ON

Вимкнення приладу

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор = OFF

Регулювання температури

Натискуйте протягом 1 сек. Блімає індикатор температури.

Підвищення температури (тепліше) - натисніть кнопку .

Пониження температури (холодніше) - натисніть кнопку .

натисніть знову.

Відбувається збереження потрібного налаштування температури.

Вказівка

У найтеплішій зоні всередині приладу температура може бути вищою ніж налаштована температура.

Якщо двері відкриті протягом тривалого часу, це може призвести до значного підвищення температури у відділенні приладу.

Режим індикації температури

Індикація температури може на вибір здійснюватися у градусах Цельсія або у градусах Фаренгейта. Заводське налаштування - це градуси Цельсія.

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор =

Натискуйте . Індикатор =

Кнопками чи можна вибрати потрібне налаштування.

0 = °C 1 = °F

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор =

Натискуйте протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

SuperFrost (супер-мороз)

Використовуйте режим SuperFrost, щоб швидко охолодити велику кількість харчових продуктів. Коли режим SuperFrost увімкнений, прилад працює на максимальній холодильній потужності.

Увімкнення режиму SuperFrost

Натискуйте протягом 3 с. Індикатор =

Укладіть свіжі продукти харчування.

Електроніка автоматично перемикається назад на нормальне регулювання.

Передчасне вимкнення режиму SuperFrost

Натискуйте протягом 5 с. Індикатор =

Сигналізація відкритих дверей

Коли відкриваються двері, світиться світлодіод і індикатор температури починає блимати.

Якщо двері відкриті довше ніж 240 секунд, починає блимати світлодіод і на дисплеї поперемінно блимають і індикатор температури.

Лунає звуковий попереджувальний сигнал (якщо функція звукового сигналу не відключена).

Якщо двері для завантаження охолоджуваних продуктів необхідно тримати відкритими довше, вимкніть звуковий попереджувальний сигнал натисканням кнопки .

Налаштування часу затримки для сигналізації відкритих дверей

Час до подачі звукового попереджувальн

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = $r^1 \zeta$

Натискайте кнопку  , поки на дисплеї не з'явиться $d \theta d$.

Натискуйте  . Індикатор = $|$ Діапазон налаштування = 1 - 5 хвилин

Кнопками  чи  можна вибрати потрібне налаштування.

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = $d \theta d$

Натискуйте  протягом 5 с. Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

Деактивація функції звукового попереджувального сигналу

Функцію звукового попереджувального сигналу за потреби можна деактивувати повністю.

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = $r^1 \zeta$

Натискайте кнопку  , поки на дисплеї не з'явиться $H \zeta$.

Натискуйте  . Індикатор = $|$

Кнопками  чи  можна вибрати потрібне налаштування.

0 = функція звукового попереджувального сигналу активна

1 = функція звукового попереджувального сигналу неактивна

Натискуйте  . Індикатор = $H \zeta$

Натискуйте  протягом 5 с. Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

Перевірка сигналізації

За допомогою цього тестового прогону можна перевірити функціональну здатність внутрішнього пристрою сигналізації і, якщо є, підключеного зовнішнього пристрою сигналізації.

Охолодження приладу під час цього тестового прогону не переривається.

Натискуйте  +  протягом 5 с.

- Температура на дисплеї змінюється на значення, що є на 0,2 °C меншим за налаштовану верхню межу сигналізації.
- Значення температури потім збільшується кожні 2 секунди на 0,1 °C.
- Після досягнення верхньої межі сигналізації на дисплеї відображається **HIO**. Пристрій сигналізації, підключений до виходу сигналізації з нульовим потенціалом, у цьому разі активується.
- Значення температури продовжує зростати до значення, що на 0,2 °C перевищує верхню межу сигналізації.
- Та сама процедура автоматично здійснюється для нижньої межі сигналізації. На дисплеї відображається **LIO**.

Під час тестового прогону світиться світлодіод .

Електроніка автоматично перемикається назад на нормальне регулювання.

Дострокове переривання тестового прогону

Натискуйте  протягом 5 с.

Вказівка

Якщо значення верхньої і нижньої меж сигналізації (**AL** і **AN** у розділі "Налаштування параметрів сигналізації") встановлені на **0**, під час тестового прогону на дисплеї відображається **H--** і **L--**.

Аварійні повідомлення

1. Світлодіод блимає на дисплеї

Поява  на дисплеї свідчить про несправність приладу. Зверніться, будь ласка, до найближчої служби сервісу.

2. Світлодіод блимає на дисплеї - індикатор HI або LO

Всередині приладу занадто тепло (HI) або занадто холодно (LO).

Лунає звуковий попереджувальний сигнал (якщо функція звукового сигналу не відключена).

Вказівка

Параметри сигналізації можна налаштувати. Див. розділ **Налаштування параметрів сигналізації**.

3. HA / блимає на дисплеї

Протягом певного відрізка часу всередині приладу було занадто тепло або занадто холодно (HA).

Налаштування параметрів сигналізації

Межі сигналізації (різниці зі встановленою температурою) і затримки сигналізації (час затримки до спрацювання сигналізації) можна налаштувати.

Натискуйте  протягом 5 с. Індикатор = $r^1 \zeta$

Натискайте кнопку  , поки на дисплеї не з'явиться $H \zeta$.

$H \zeta$ = нижня межа сигналізації

Натискуйте  . Індикатор = різниця температур у °C

Кнопками  чи  можна вибрати потрібне налаштування.

Встановлюйте лише додатні числові значення!

Натискуйте  . Індикатор = $H \zeta$

Натискуйте  . Індикатор = $H \zeta$ верхня межа сигналізації

Натискуйте  . Індикатор = різниця температур у °C

Кнопками  чи  можна вибрати потрібне налаштування.

Встановлюйте лише додатні числові значення!

Натискуйте  . Індикатор = $H \zeta$

Натискуйте  . Індикатор = $H \zeta$

Натискуйте  . Індикатор = затримка сигналізації у хвилинах

Кнопками  чи  можна вибрати потрібне налаштування.

Натискуйте  . Індикатор = $H \zeta$

Натискуйте  протягом 5 с.

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

Зчитування температурного режиму

Натискуйте **НАССР** Індикатор = **г t**

Використовуйте кнопки **✓** або **△** для переміщення у списку.

г t проміжок часу у годинах, протягом якого було виміряне максимальне і мінімальне значення температури всередині приладу

г H найвища (найтепліша) виміряна температура

г L найнижча виміряна температура

Кнопкою **⚙** виберіть потрібний пункт. Якщо натиснути цю кнопку ще раз, відбувається повернення до списку.

Вказівка: щоб вийти з цього меню достроково, тримайте кнопку **⏏** натисненою протягом 5 сек.

Якщо протягом 60 секунд не натискається жодна з кнопок, електроніка автоматично перемикається у попередній режим.

Скидання аварійних станів

Натискуйте **НАССР** Індикатор = **г t**

Натискуйте **НАССР** + **△** протягом 5 с. Індикатор = **г E 5**

Натискуйте **⏏** протягом 5 с. Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

Скидання записаного температурного режиму **г t**

Натискуйте **НАССР**. Індикатор = **H H g**

Натискайте кнопку **✓** або **△**, поки на дисплеї не відобразиться **г t**.

Натискуйте **⚙**. Індикатор = **0 - 999**

Натискуйте **✓** протягом 5 с. Індикатор = **г E 5**

Значення **H g L** (найвища або найнижча виміряна температура всередині приладу) скидаються при цьому до температури, наявної наразі всередині приладу.

Натискуйте **⏏** протягом 5 с. Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

Скидання параметрів до заводських налаштувань

За допомогою цієї функції можна скинути **межі сигналізації** і значення **калібрування датчиків** на заводські налаштування.

Витягніть штепсель з розетки.

⏏ утримуйте натиснутою і устроїть мережний штепсель.


Індикатор = **b n l**

Натискуйте **⚙**. Індикатор = **5 t d**

Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

Зберігання

Полиці можна переставляти у залежності від висоти пляшок або упаковок.

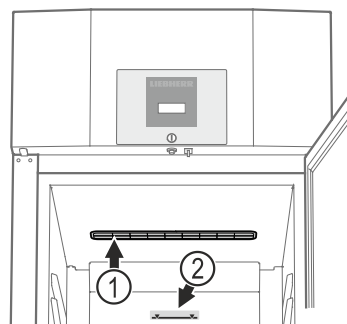

(1) Не закривайте вентиляційні щілини вентилятора циркуляційного повітря всередині приладу!

(2) Позначка укладання **→**

На верхній полиці зберігайте продукти лише до позначки укладання. Це важливо для безперешкодної циркуляції повітря і рівномірного розподілу температури у всьому внутрішньому просторі.

Увага

Зберігайте сире м'ясо або рибу у чистих, закритих посудинах на нижній полиці холодильної/морозильної камери, щоб вони не торкались інших харчових продуктів і рідина не могла потрапити на інші харчові продукти.

Недотримання цих вказівок може призвести до псування харчових продуктів.

Розморожування

Холодильна камера розморожується автоматично.

Ручне увімкнення функції розморожування

Якщо двері були неправильно закриті протягом тривалого часу, всередині приладу або на генераторі холоду може виникнути сильне обледеніння. У цьому разі можна завчасно увімкнути функцію розморожування.

Натискуйте ***⏏** протягом 3 с. Індикатор = **❄ + d F b**

Електроніка автоматично перемикається назад на нормальне регулювання.

Індикатор = **d F E**

Налаштування індикації на дисплеї під час фази розморожування

Натискуйте **⏏** протягом 5 с. Індикатор = **г t 5**

Натискайте кнопку **△**, поки на дисплеї не з'явиться **d b**.

Натискуйте **⚙**. Індикатор = **|**

Кнопками **✓** чи **△** можна вибрати потрібне налаштування.

0 = символ **❄** + поперемінне відображення **d F F** і тогочасної температури всередині приладу.

1 = символ **❄** + температура до початку фази розморожування (заводське налаштування).

2 = символ **❄** + **d F F**.

Натискуйте **⚙**. Індикатор = **d b**

Натискуйте **⏏** протягом 5 с. Електроніка знову перемикається у нормальний режим роботи.

Очищення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед очищенням слід обов'язково вимкнути електроживлення приладу. Витягніть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник!

Поверхні, які можуть контактувати з харчовими продуктами і звичайними дренажними системами, необхідно регулярно очищувати!

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження компонентів приладу і травмування гарячою парою.

Не очищуйте прилад за допомогою пароочищувачів!


- Внутрішні поверхні, деталі обладнання і зовнішні стінки слід мити теплою водою з додаванням невеликої кількості миючого засобу. У жодному випадку не можна застосовувати чистильні засоби, що містять пісок або кислоти, або хімічні розчинники.
- Щоб запобігти короткому замиканню, під час очищення приладу слідкуйте за тим, щоб вода для миття не потрапляла в електричні компоненти.
- Миті поверхні треба добре просушити шматком сухої тканини.
- Холодильну установку з теплообмінником (металева решітка ззаду на пристрої) слід раз на рік мити або пилососити.
- Не можна пошкоджувати або знімати фірмову табличку на внутрішній стороні приладу - вона важлива для виконання сервісних робіт.

Очищення пилозахисного фільтра

Очищуйте пилозахисний фільтр не менше 2 разів на рік!

Витягніть штепсель з розетки!

- Вийміть пилозахисний фільтр, потягнувши його донизу.
- Очистьте пилозахисний фільтр водою і миючим засобом.
- Знову монтуйте пилозахисний фільтр.

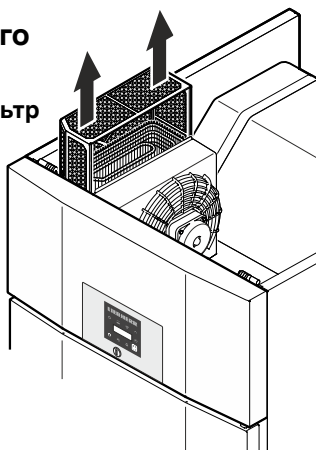

Вказівки з утилізації

Прилад містить цінні матеріали і повинен здаватися у вторсировину. Утилізація відпрацьованих приладів повинна здійснюватися відповідно до чинних в конкретній місцевості приписів і законів.



Стежте за тим, щоб при вивезенні відпрацьованого приладу не був пошкоджений контур охолодження.

Цей прилад містить горючі гази у контурі охолодження і в ізоляційній піні.

Інформацію про належну утилізацію надає адміністрація міста/громади або підприємство з утилізації.

Несправності

Ви можете самі усунути наступні несправності, перевіривши їх можливі причини.


• Прилад не працює. Перевірте

- чи увімкнений прилад,
- чи правильно вставлен штепсель в розетку,
- чи в порядку запобіжник розетки.

• Температура недостатньо низька. Перевірте

- настройку відповідно до розділу "Регулювання температури", чи правильно встановлена температура?
- Чи показує окремо поміщений в прилад термометр потрібну температуру.
- Чи в порядку витяжна вентиляція?
- Чи не знаходиться поблизу від місця установки приладу джерело тепла?

Якщо жодна з перерахованих причин не має місця і Ви самі не в змозі усунути несправність, зверніться в найближчу службу сервісу. Повідомте тип ①, номер сервісу ② і номер приладу ③, вказані на заводській табличці.

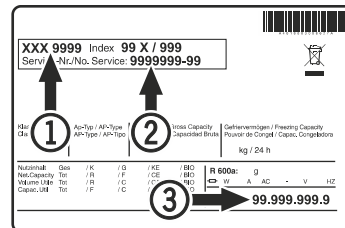

Розташування заводської таблички зазначене в розділі **Опис приладу**.

Можливі повідомлення про помилку на дисплеї

Код помилки	Несправність	Захід
E0, E1, E2, rE	Температурний датчик несправний	Зверніться у службу сервісу
EE, EF	Помилка електроніки управління	Зверніться у службу сервісу
dOr	Двері приладу відкриті занадто довго	Закрийте двері приладу
HI	Температура у приладі занадто висока (тепла)	Перевірте, чи правильно закриті двері. Якщо температура не опуститься, зверніться у службу сервісу.
LO	Температура у приладі занадто низька (холодна)	Зверніться у службу сервісу
HA	Протягом певного відрізка часу всередині приладу було занадто тепло або занадто холодно.	див. розділ Зчитування температурного режиму


Виведення приладу з експлуатації

Якщо прилад тривалий час стоїть пустий, його потрібно вимкнути, розморозити, очистити і висушити, а двері тримати відкритими для попередження утворення плісняви.

Перенавішування дверей GGPv 65..

Перенавішування дверей повинно виконуватися лише силами спеціально навчених фахівців.

Для перенавішування потрібні дві особи.

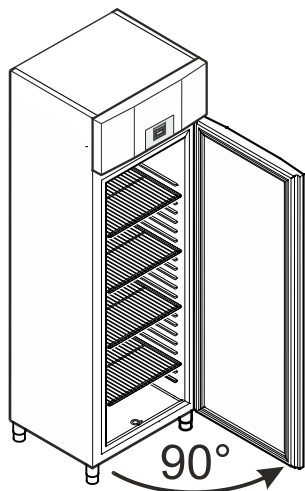

1. Відкрийте двері прибіл. на 90°.

Важлива вказівка

Перед демонтажем нижнього шарнірного куточка двері необхідно відкрити на 90°.


Це дозволяє утримувати вбудований у двері механізм самозакриття у положенні, необхідному для монтажу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо двері були демонтовані у закритому стані, а потім знову монтовані, це призведе до знищення механізму самозакриття під час першого відкриття таких дверей.

Важлива вказівка


Через велику масу дверей необхідно, щоб її підтримувала одна окрема людина.

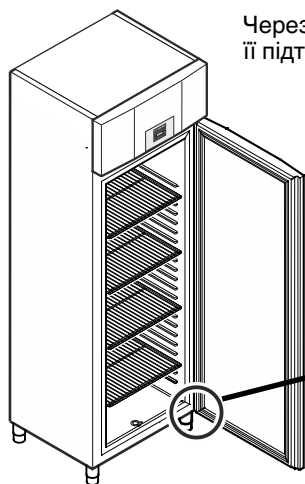



1. Відкрутіть шарнірний куточок.

Зніміть двері вниз.

3. Зніміть кільце підшипника з верхнього підшипника дверей.

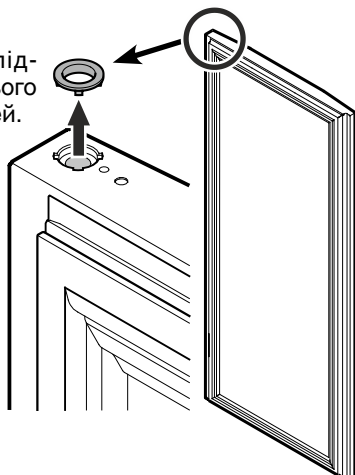


4. Зніміть частини підшипника з шарнірного куточка.

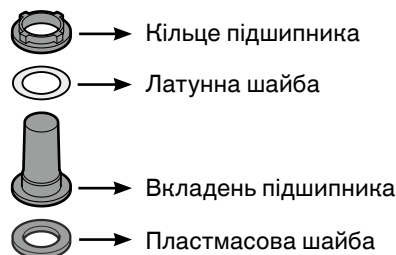


Вказівка щодо пункту 4


Якщо вкладки підшипника з латунною шайбою і кільце підшипника під час виймання шарнірного куточка залишились у підшипнику дверей, їх потрібно вийняти звідти.

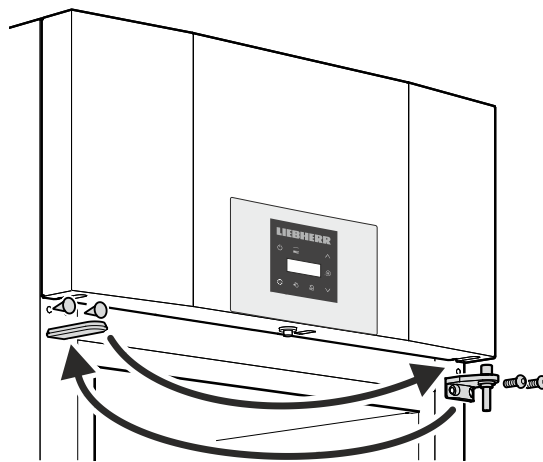

5. Переставте шарнірний куточок і кришки на протилежні сторони.


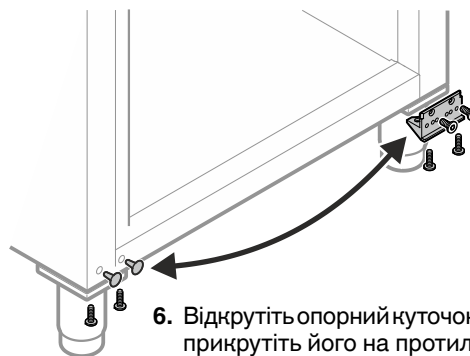


6. Відкрутіть опорний куточок підшипника і знову прикрутіть його на протилежну сторону.

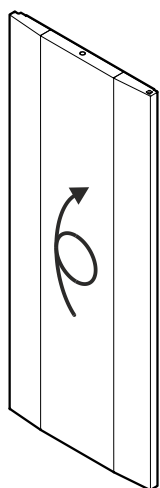

7. Поверніть двері на 180°.

8. Устроміть кільце підшипника і вклавдень підшипника у верхній підшипник дверей.

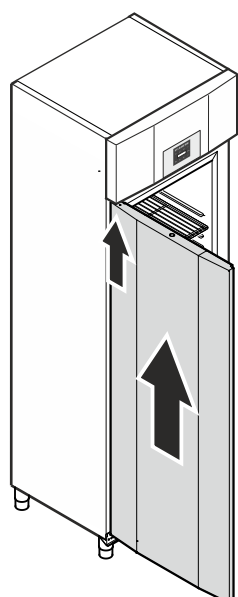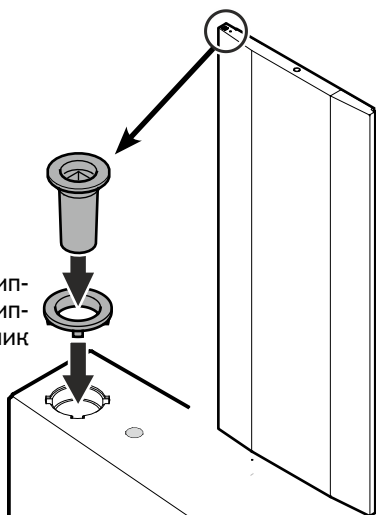

9. Надіньте двері, відкриті під кутом 90°, на верхній чотиригранний штифт.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Обов'язково монтуйте двері, відкриті під кутом 90°.

Якщо двері були монтвані у закритому стані, це призведе до знищення механізму самозакриття під час першого відкриття і закриття таких дверей.


Важлива вказівка

Через велику масу дверей необхідно, щоб її підтримувала одна окрема людина.

10. Надіньте деталі підшипника на шарнірний куточок.

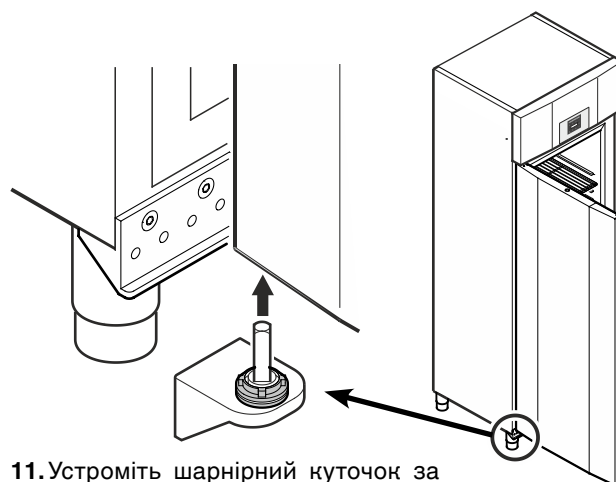


11. Устроміть шарнірний куточок за надітими деталями підшипника у нижній підшипник дверей.

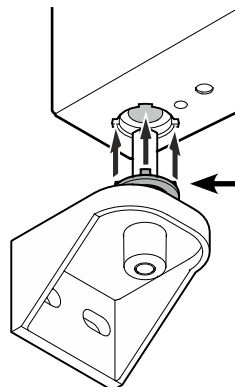

Вказівка щодо пункту 11

Виступи на кільці підшипника під час встромляння повинні увійти у виїмки підшипника дверей.

За потреби трохи поверніть верхнє кільце.

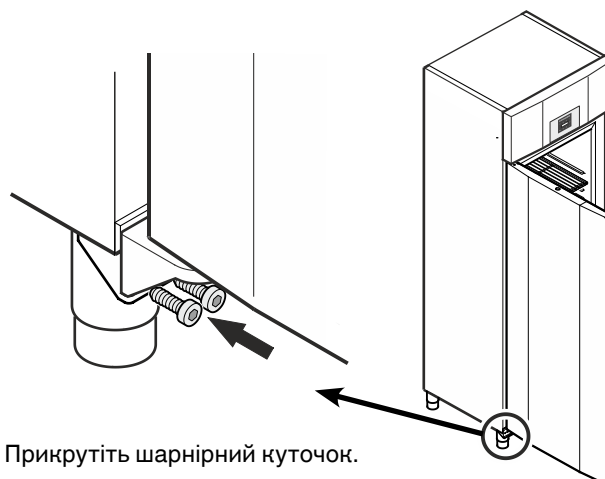

12. Прикрутіть шарнірний куточок.



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

